



床ずれ防止マット
(エアー噴出型)

エアーマット

商品コード：0-3678-01

取扱説明書


商品についてのお問い合わせ先

お買上げ年月日 平成 年 月 日	
購入先店名	
住 所	
電 話	

△注意 床ずれ・病臭防止マットを、安全にご使用いただくために！
(ご使用の前に必ずお読みください)

- ① マットの上で喫煙しないで下さい。
- ② 本製品は、交流 100V 以外で使用しないで下さい。
- ③ 調節器は分解したり、濡らしたりしないで下さい。
- ④ 刃物や尖った物を、マットの上に置かないで下さい。
- ⑤ 調節器を高い所から落としたり、衝撃を与えないで下さい。
- ⑥ 他機種や他製品のマット 調節器との組合せは絶対にしないで下さい。
故障の原因になります。

ナビス エアーマット 各部の名称

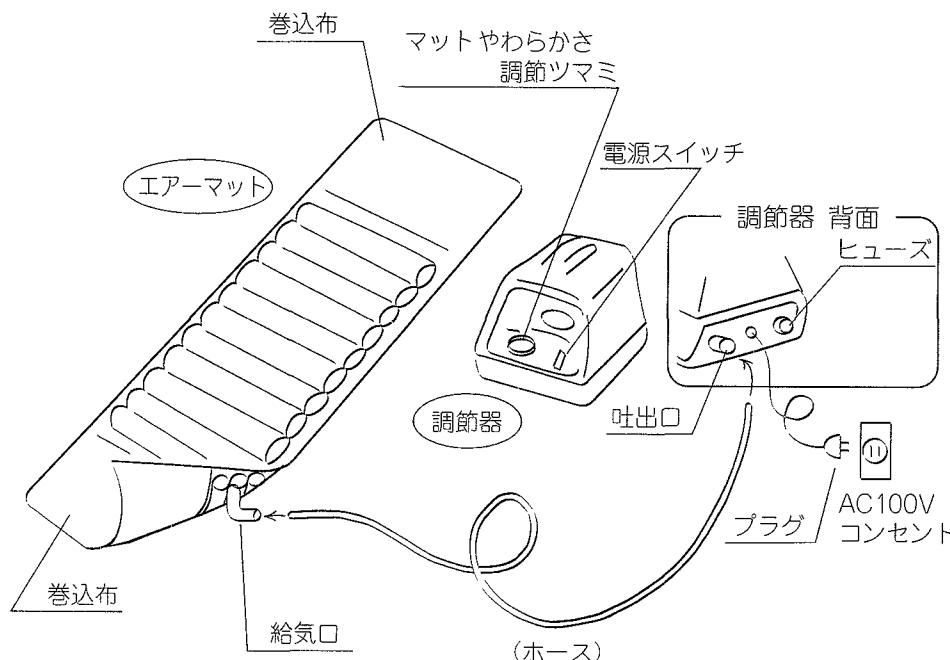

■ご使用方法

- ① マットをベッドのマットレス(又はタタミ)の上に直接敷きます。
マットの上面が表面ですから、必ず上面を上向きに置いて下さい。
(表裏を間違うと効果がありません)
- ② 卷込布をマットレスの下に巻き込んで下さい。
- ③ マットの上に、敷布か毛布を敷くのは宜しいですが、通気の悪い
ビニール(ゴム)シートや敷布団は絶対に敷かないで下さい。
(噴出空気の流通が妨げられて効力が激減します)
- ④ マットの給気口を足元側にして、患者さんを寝かせて下さい。
- ⑤ マットと調節器を付属のホースで連結し、プラグを電源に差し込み、
スイッチを「入」にすると約10分でマットがふくらみます。
- ⑥ マットは軟らかめに使用するのが効果的です。

効力の実証試験

使用する前に、腰部の下に手を差し入れて、湿りの程度を確認しておきます。使用1週間後に手を入れ、皮膚が乾燥状態になっていれば、この装置が効力を発揮している証拠です。

●最適なやわらかさは

仰向け状態でおしり、
かかとなどが底着きしない程度の軟らかさが最適です。

下図のようにエアーマットのおしりの部分とマットレス
(または敷布団)との間が1~2cmになっている事を手の
ひらを差し込み確認して下さい。



■ご注意

- ① なるべくオムツカバーで密閉せずに、バスタオルで腰の回りを囲んで下さい。(排尿を吸収します)
- ② マットからの微風は患者さんに快く感じられますが、冬季とくに
寒く感じる場合は、マットの直接下に電気毛布をしくと暖かくな
ります。(足元にアンカを置くのも結構です)
- ③ マットは速乾性ですから、汚れを石鹼水でブラシ洗いができます。
(マットを強くふくらませた状態で、洗ってすぎ、陰干しにします)
- ④ 介護する人が、マットの上にのる場合、電源を切って、しばらく
してからのって下さい。

■仕様

	寸法(mm)	重量	電源
マット	1900×810×85	2.5kg	—
調節器	310×170×175	3.1kg	AC 100V、50/60Hz、8.5W
ヒューズ	Φ6.4×30	—	125V、0.5A

*マットは充気時の寸法です。