

# 取扱説明書

Instruction Manual

# スライドストレッチャー




8-2231-01 LS-6C

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

この製品は搬送・移乗用のストレッチャーとして設計されています。

ご使用の前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。  
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

## 外観図

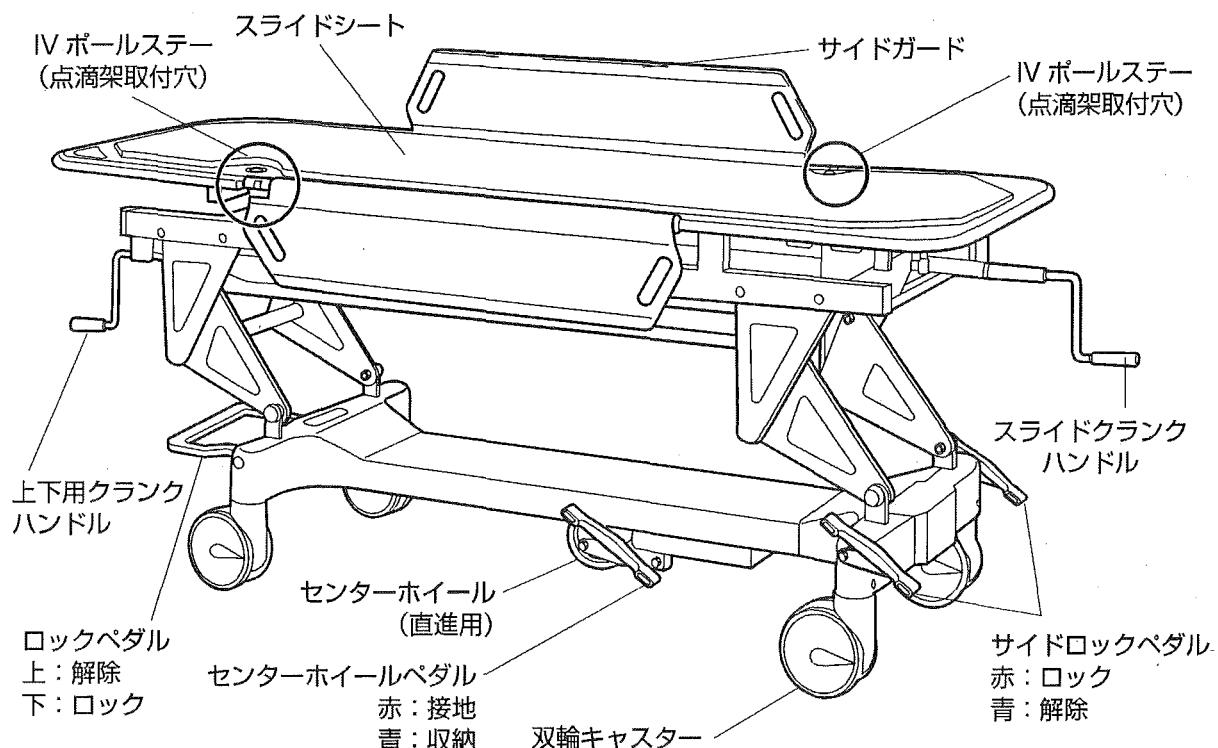

## ご使用の前に (安全上の警告・注意)

出荷時に十分に検査しておりますが、ご使用いただく前には安全のため、都度点検をお願いします。  
ストレッチャーに付属している各部品がきちんと付いているか、各部品に傷やねじれ等の症状はないか、使用しているうちに各機能のガタつきや不具合はないか、点検をお願いします。  
もし異常がありましたら使用を中止し、お買い上げの販売店もしくは弊社まで御連絡ください。

**⚠ 警告** 取扱いを誤ると、人身事故・製品の破損の原因となることがあります。

- 人を乗せて手押し移動または、移乗用ストレッチャー以外の目的に使用しないでください。
- 本ストレッチャーは1人乗り専用です。定員以上の乗車をしないでください。
- ストレッチャーの損傷や事故・転倒によるケガをする原因となります。製品の強度・品質について  
は手押しの平坦床面での使用を想定しています。また、体重220kg以上の人には使用しないでく  
ださい。

- 本ストレッチャーはMRI用には設計していません。磁性体を含んだ金属を使用しておりますので、絶対にMRI室では、ご使用にならないでください。
- 故障・異常のあるときには使用しないでください。  
故障や異常状態で使用すると、事故・転倒などによるケガの原因となります。
- 改造をしないでください。改造によりストレッチャーの部品の破損・脱落・折損などで安全性が低下して事故・転倒の原因となります。
- ストレッチャーに人を載せおろしする際には、平坦な場所で停止し、必ずロックペダルで4輪ともブレーキを掛けて固定していることを確認してください。
- ストレッチャーが固定されていないと転倒・転落してケガをする原因となります。
- ストレッチャーの上に立った状態で乗らないでください。転倒やシート部の破損の原因となります。
- ストレッチャーに人を乗せる場合は、スライドシート前後中央から等分に体重が分散するように載せてください。
- スライドシート片端に体重が掛かるような載せ方をして移動すると、走行バランスが悪く、転倒・転落してケガの原因となります。
- 移動時にはサイドガードを左右両側とも上げ、ロックした状態で移動・運搬を行ってください。  
ストレッチャーのサイドガードを下げた状態で移動・運搬すると、転倒・転落してケガの原因となります。
- IVポール（点滴架）には輸液・補液バッグやボトル以外のものを掛けないでください。安全のため、フックには5kg／本以上のものを掛けないでください。フックやポールにぶら下がったりしないでください。IVポールの高さ調整ノブはしっかりと締めてご使用ください。
- IVポール（点滴架）を使用しない時には、ベッドパネルの下のIVポール収納スペースに差し込んで保管してください。

---

**△ 注意** 取扱いを誤ると、人身事故・製品の破損の原因となることがあります。

---

- 階段・段差・ミゾ・長い上り坂・下り坂での使用は危険です。  
ストレッチャーに乗っている人や介助している人がケガをする原因となります。
- エレベーターを使用する場合には、ドアの隙間に車輪を落としこまないようにしてください。  
無理に脱出しようとすると、エレベーター・ストレッチャーを破損し、患者様もケガをする原因となります。本体を持ち上げるように介助して脱出してください。
- IVポール（点滴架）を使用時にはスライドシートを移動させないでください。破損の恐れがあります。

---

**使用前／定期的に下記の各部の点検・整備・清掃を行ってください。**

- 各部のボルト・ナットに緩みはありませんか？
- フレームやパイプに変形はありませんか？
- キャスター・ブレーキのロックは正しく掛かりますか？
- キャスターの回転は正常ですか？
- マットレスに傷や破損はありませんか？
- 各部の清掃と可動部分の注油（市販の潤滑剤）をしてください。
- 普段と比べ、異常音・違和感はありませんか？

## 使用方法

### A) ロックペダル・サイドロックペダルの操作

停車・移乗時：キャスター集中ロックを掛けるとき

ロックペダルを下まで踏み込むか、サイドロックペダルの赤色側を踏み込んでください。双輪キャスターが旋回・前後回転ともに4輪全てフルロックされます。

搬送時：キャスター集中ロックを解除させるとき


ロックペダルを爪先などで上に上げるか、サイドロックペダルの青色側を踏み込んでください。双輪キャスターが旋回・前後回転ともに4輪全てフリーになります。

### B) センターホイール（直進用）の操作

- センターホイール（直進用）は、走行の際、直進安定性を高めるための機能です。
- 直進走行をする際には、本体フレーム下部中央にあるセンターホイールペダルの「赤いマークのあるペダル」を踏み、センターホイールを接地させてください。移動の際ストレッチャーのふらつきを防止します。
- ベッドへ寄せる際などストレッチャーを左右に移動したい場合、センターホイールペダルの「青いマークのあるペダル」を強めに踏み込んでください。センターホイールが上がり、横向に移動させることができます。

### C) 上下用クランクハンドルの操作

- クランクハンドルをご使用の時には把手を上に引き上げてください。
- 上下用クランクハンドルを右に廻すとベッド面が上に上がり、左に廻すと下に下がります。
- ベッド面の高さを上下に調節してご使用ください。
- 使用しないときにはクランクハンドルの根元のスリーブ（筒）を手元に引きながら、ハンドルを倒して収納してください。

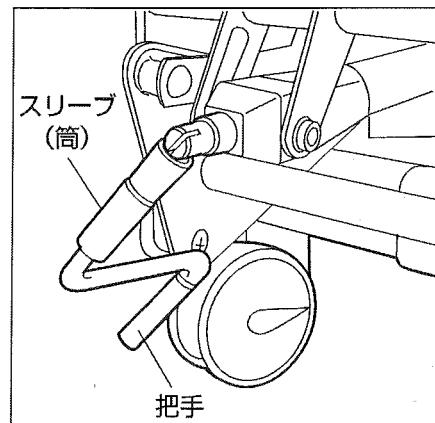

### D) サイドガードの操作

使用時：サイドガードを下から上に上げ完全にロックされるまで上げてください。（転落防止）

クランクハンドル収納時

乗車・収納時：サイドガードのグリップ部分を握りながら、スライドクランクハンドル側へ、水平に強く引いて下に倒してください。


移乗時：サイドガードはストレッチャーからベッドへの渡し板として使用します。  
移乗時はスライドシートと一直線になるように、並行にベッドへ渡してください。

### E) スライドシート使用方法

- スライドシートを使用することにより、患者様をよりスムーズにベッドからストレッチャーへ、ストレッチャーからベッドへ、移乗させることができます。
- できるだけベッドとストレッチャーの隙間が出来ない様、ギリギリまで寄せて、ロックペダルをしっかりとロックしてください。
- サイドガードをD)の要領でベッドに水平に倒してください。
- スライドクランクハンドルを右に廻せばスライドシートが右に、左に廻せばスライドシートが左に移動します。（左右中心より約30cmずつ）
- 下図の要領でスライドシートをご使用ください。  
その際に、必ずストレッチャーのベッド面と、ベッドの高さを同じ高さにしてください。

### 簡単操作で ストレッチャーから ベッドへ

スライドシートは左右に可動しますので、患者様をよりスムーズにベッドからストレッチャーへ、ストレッチャーからベッドへ、移乗させることができます。

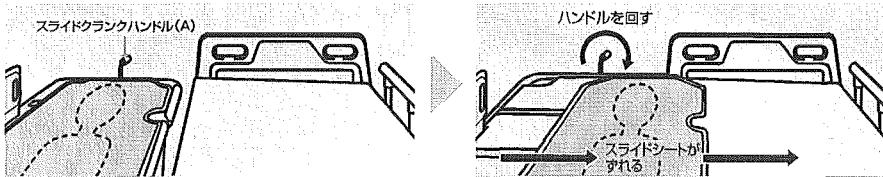

患者様の移乗を終えましたら、スライドシートを元の位置まで戻し、スライドクランクハンドルを前述 C) 上下用クランクハンドルの操作と同様に収納してください。

### F) IVポール（点滴架）使用方法

本体ベッド面2箇所にあるIVポールステー（取付穴）のどちらかにしっかりと差し込み、高さ調節ノブで任意の高さにしっかりと固定してください。

なお、フック部分には輸液・補液以外のものを掛けないでください。（耐荷重：約5kg／本）

※ 本体にはIVポールの収納スペースはありませんので、別途保管してください。

### お手入れ方法

- 本商品を末永くご使用いただくために、定期的にお手入れしてください。
- 汚れは、乾いた柔らかい布で拭き去ってください。汚れがひどい場合には、適度に薄めた中性洗剤を含ませた布で、ふき取ってください。その後、水で濡らした柔らかい布をよく絞り、洗剤をふき取って、最後に乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。  
(※シンナー等の有機溶剤・粉石けん・みがき粉・中性洗剤以外の洗剤類・熱湯・酸・アルカリ・たわし等はお使いにならないでください。)

## 仕様

品番	8-2231-01
商品名及び型番	スライドストレッチャー LS-6C
本体外寸	W630×L1950×H610～920mm
ベッドサイズ	W630×L1910mm カートンサイズ／W690×L1990×H805mm (ハンドフォーク使用可)
サイドガードサイズ	W937×H181mm
製品重量	89kg (IVポール含む)
搬送耐荷重	約220kg
IVポールサイズ	使用時：全高1465～2080mm、全幅／245mm
キャスター径	双輪キャスター／φ150mm (双輪自在タイプ・セントラルロック式) ×4 センターホイール／φ125mm (ゴム製・単輪固定タイプ) ×1
付属品	IVポール (2本架) ×1
材質	フレーム／スチール (粉体塗装)、IVポール／スチールメッキ・ABS樹脂 サイドガード／アルミ合金、スライドシート／ビニールレザー・樹脂

(本仕様は性能向上のため、予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。)

※ 本スライドストレッチャーには下記の商品機能はありませんので、予めご了承ください。

- 酸素ボンベ架
- IVポール (点滴架) 収納スペース
- マットレス

Made in CHINA

販売元：アズワン株式会社 大阪市西区江戸堀2-1-27

## 保証規定

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
- ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
  - ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
  - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
  - ・接続している他の機器が原因による故障。
  - ・車両・船舶等での使用による故障。
  - ・消耗部品、付属部品の交換。
  - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

## 保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。

品 名	スライドストレッチャー
型 式	LS-6C
保 証 期 間	お買い上げ日より1年間
お買 上げ日	年 月 日
お 名 前	様
ご 住 所	TEL.
取 扱 店 名	担当者印
住 所	TEL.

## 商品についてのお問い合わせは

### カスタマー相談センター

受付時間：午前9時～午後5時30分まで  
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません。

○○ 0120-711-875 (フリーダイヤル)

FAX 0120-700-763 (フリーダイヤル)

問い合わせ  
専用 URL <http://help.as-1.co.jp/q>

 **アズワン** 株式会社