

取扱説明書

1-4477-12
発塵作業用ブース
FKD-EG915A

このブースには HEPA フィルターユニットが別梱包で附属します。
HEPA フィルターユニットについてはそちらの取扱説明書を参照ください。

お買い上げ有り難うございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。
本製品をより安全に、また、良好な状態でご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
また、製品を末永くご使用いただくために、この「取扱説明書」は大切に保管してください。
本品を譲渡・貸与される時には、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱い説明書を、製品本体と共に必ずお渡しください。

 **アズワン株式会社**

安全上のご注意

この取扱説明書では製品を安全に、正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って、安全にご使用いただくようお願い申し上げます。

各警告表示の定義

	危険	取扱いを誤ると、死亡または重症を負う可能性があります。
	警告	取扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
	注意	取扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
	お願い	安全を確保するために注意が必要な事項。

いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守り下さい。

安全確保の図記

	特定しない一般的な注意、警告、禁止事項		分解及び改造により感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止
	機器の特定の場所に触れると傷害が起こる可能性がある場合の禁止		感電の危険性の注意
	破裂、爆発の危険性の注意		ファン等に巻き込まれる危険性の注意
	特定しない一般的な使用者の行為		アース線の接続の指示

<設置上の安全に関する注意>

製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、適切な場所をお選びください。

 警告	
	・近くに引火性の固体・液体・気体のないところ。 ・周囲温度が 5～40℃以内のところでご使用ください。
 注意	
	・結露しないところ。 ・水平で安定したところ。 ・直射日光のあたらないところ。 ・電源コードは、足を引っ掛けないようなところに取りまわしてください。 ・クリーンユニットと天井との間が密閉状態ならないように、5cm 以上の隙間が取れるところ。

本製品を屋外で使用することは避けてください。

<使用上の安全に関する注意>

 警 告	
	・改造及び分解はしないでください。改造及び分解したものを使用して事故がおきた場合、当方は一切の責任を負いかねます。
	・シンナー、ベンジン等、引火性、爆発性気体のある雰囲気では絶対に使用しないでください。火災や爆発事故の原因となります。
	・電源プラグの差し込みがゆるいコンセントは使用しないでください。接触不良により、火災の原因となる場合があります。
	・運転中にクリーンユニットの中に手を入れないでください。プレフィルターの下は直ぐにファンがあります。回転に手をまきこまれ、ケガする恐れがあります。
 注 意	
	・長期間使用しない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。又、電源プラグを抜く時は、プラグ部分を持って抜いてください。
	・クリーンユニットの吸い込み口はふさがないでください。 ・電源は AC100V、15A 以上の電源をブースのみに使用してください。同じ電源に他の機器を接続しないでください。
	・HEPA フィルターのろ材には触らないでください。少しでもろ材が破損しますと、十分なクリーン度が保てなくなります。 ・長時間使用しない時は、HEPA フィルターに埃が入り込まないようにカバー等を掛けるようにしてください。


<カーテンについて>

本製品のカーテンには、貼り付き防止のための粉末を添加しております。ご使用になられる際は、ご面倒ではございますが、お拭き取り下さいます様お願い致します。

<取扱いについて>

- ・本器はブース内に浮遊する粉体を吸収し、排気する物です。作業台、床面等に落下した物を吸引排気する物ではありません。
- ・本器は粉塵防爆構造器具ではありません。爆燃性粉塵危険場所や可燃性粉塵危険場所での使用、又は、それらの粉塵の吸引、吸着は行わないでください。

<外観及び各部の名称>

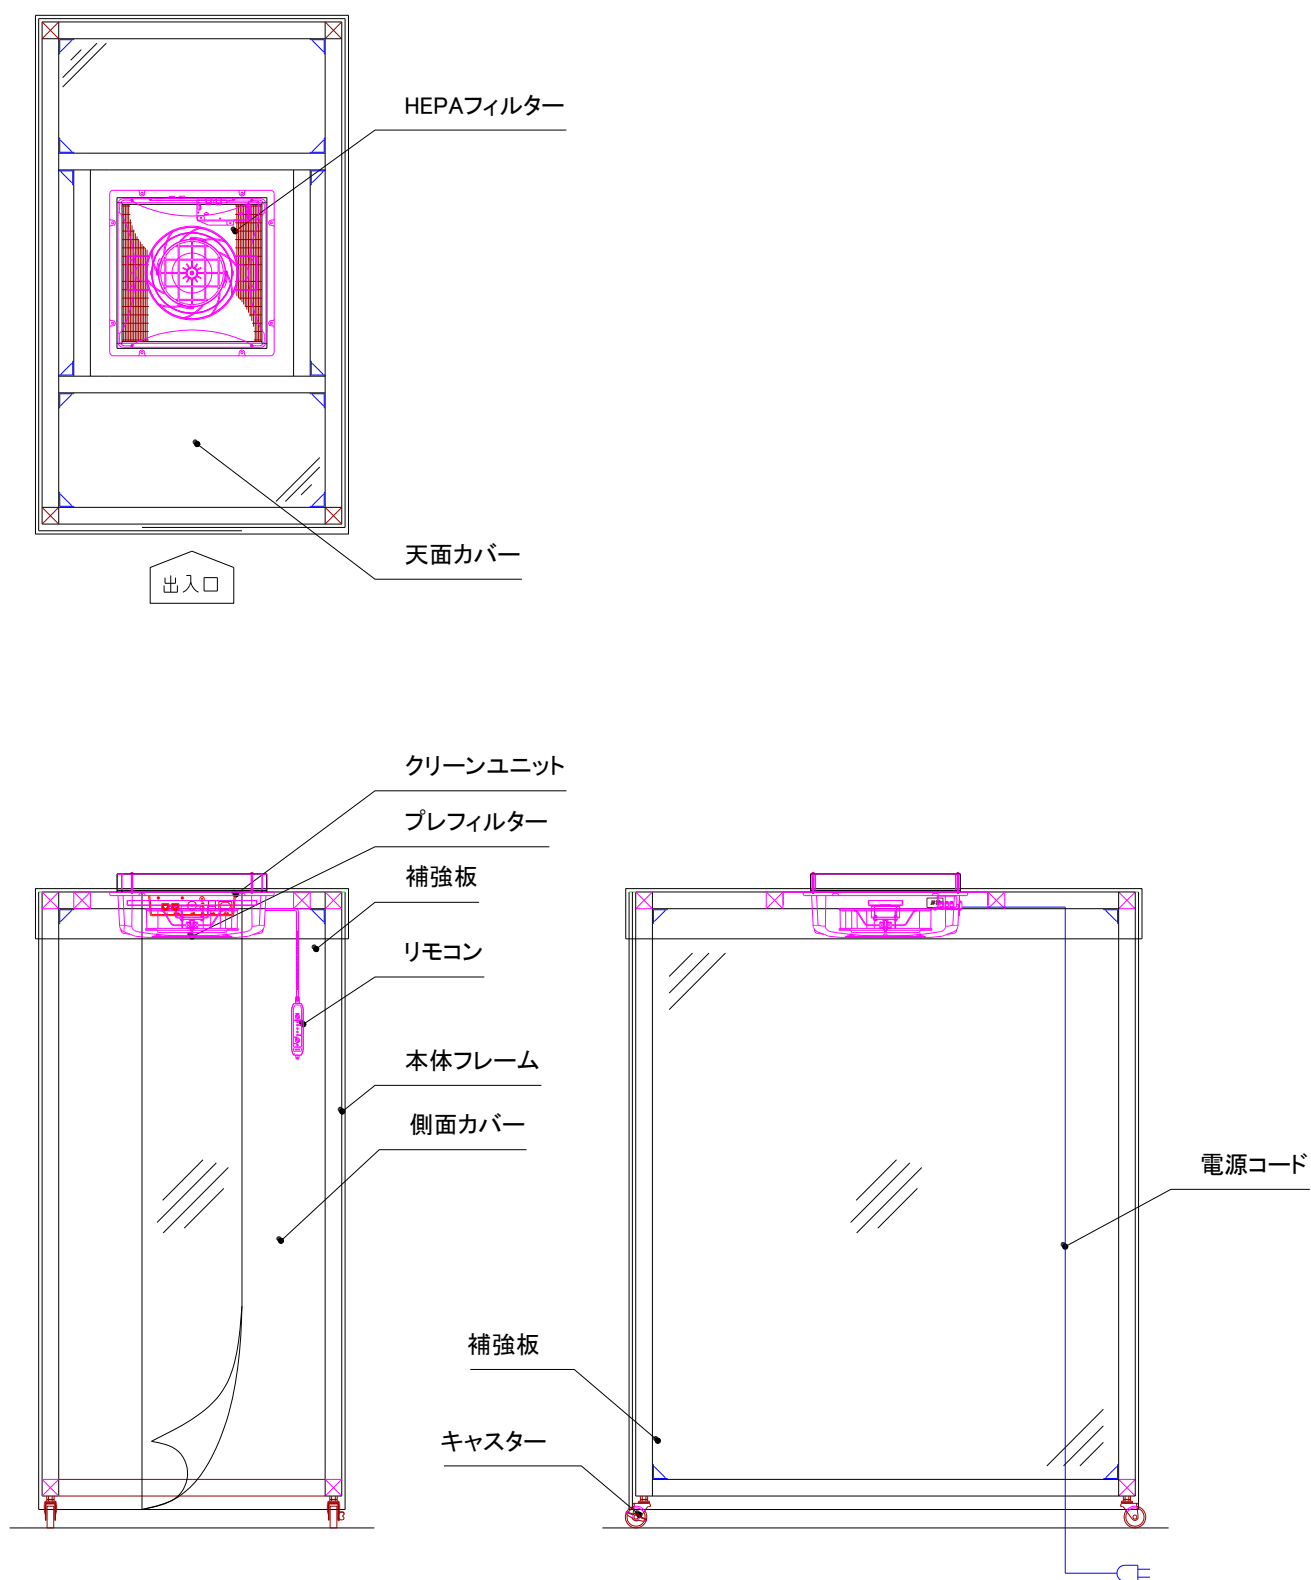

＜組立方法＞

組立作業は安全と製品等の破損防止のため、2名以上でおこなって頂く事をお勧め致します。

1. 本製品のアルミフレームにはフレーム四面に2本ずつM4 タップ溝があり、その溝にはM4 のビスがどこにでも固定できるようになっております。図 1 を参照し、アルミフレームにある M4 タップ溝とコーナー補強の穴を合わせ、フレームとフレームの間に隙間がないように突き当てて付属の M4 ビスで固定してください。

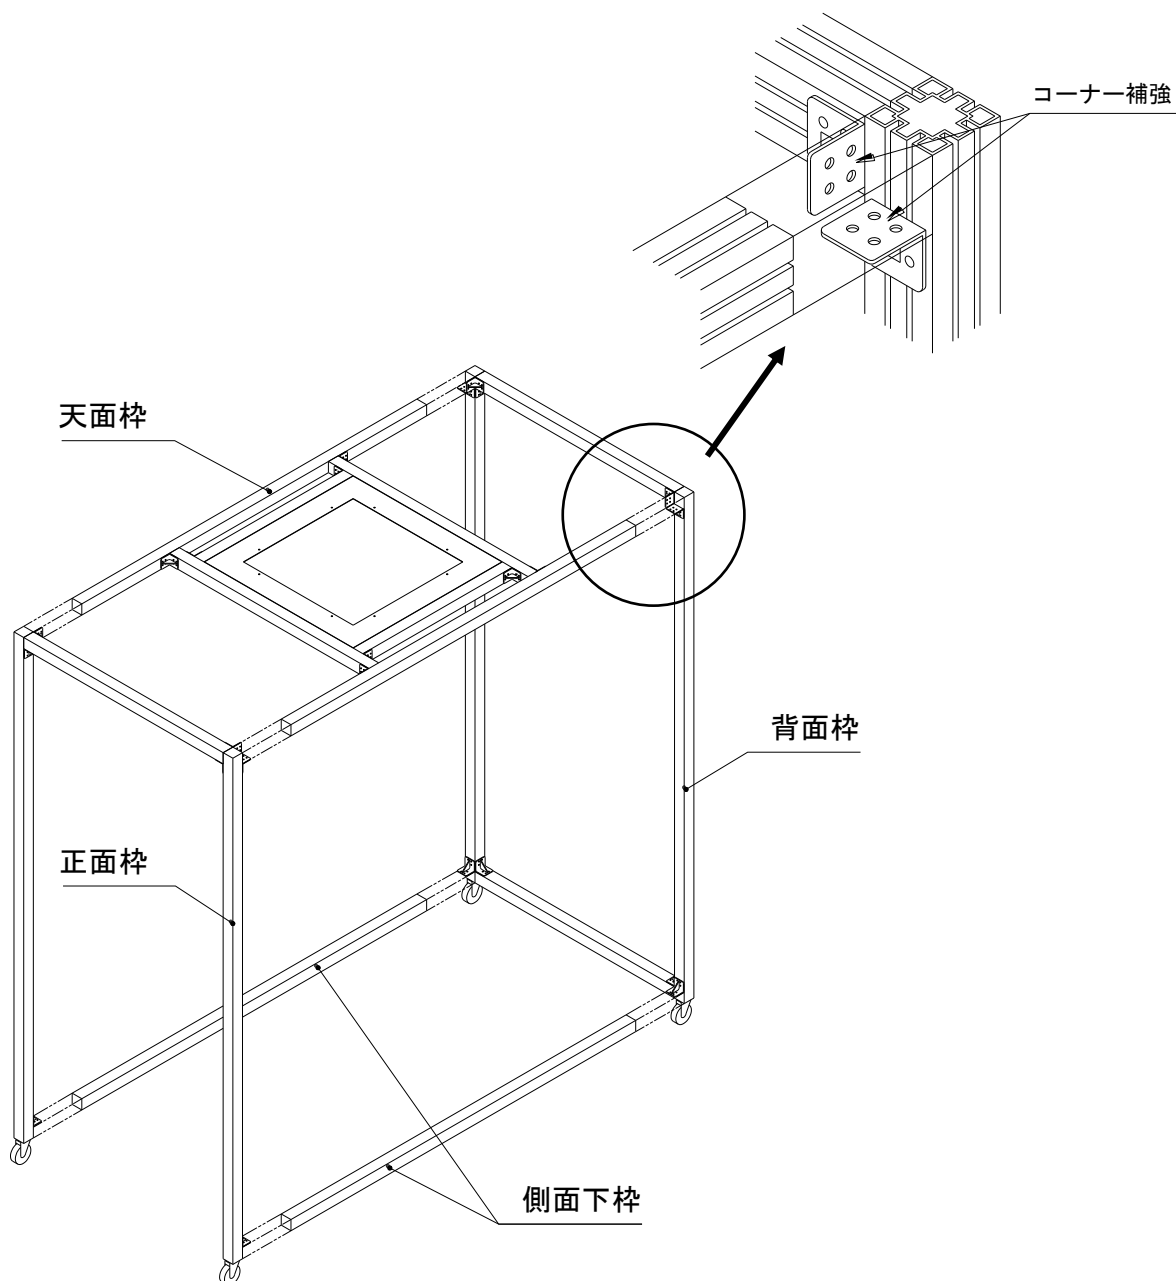


図-1

2. 別梱包で付属のクリーンユニットに同梱されている取扱説明書を参考に、クリーンユニットに電源コードとリモコン用ケーブルを接続してください。
3. 付属のユニット固定用ビスを使用して図-2のように本体フレーム内側から HEPA フィルターが上向きになるようにクリーンユニットを取付けてください。
 ※クリーンユニットは通常、ラベル面が正面ですが 450mm 角（正方形）となっており、四方向どの方向でも天面枠に乗せる事ができますので、使用される電源コンセントに近い方向へクリーンユニットから出ている電源コードが来るように固定してください。
4. 必要に応じて付属のケーブルクランプを使用して本体フレームに電源コード、リモコン用ケーブルを固定してください。

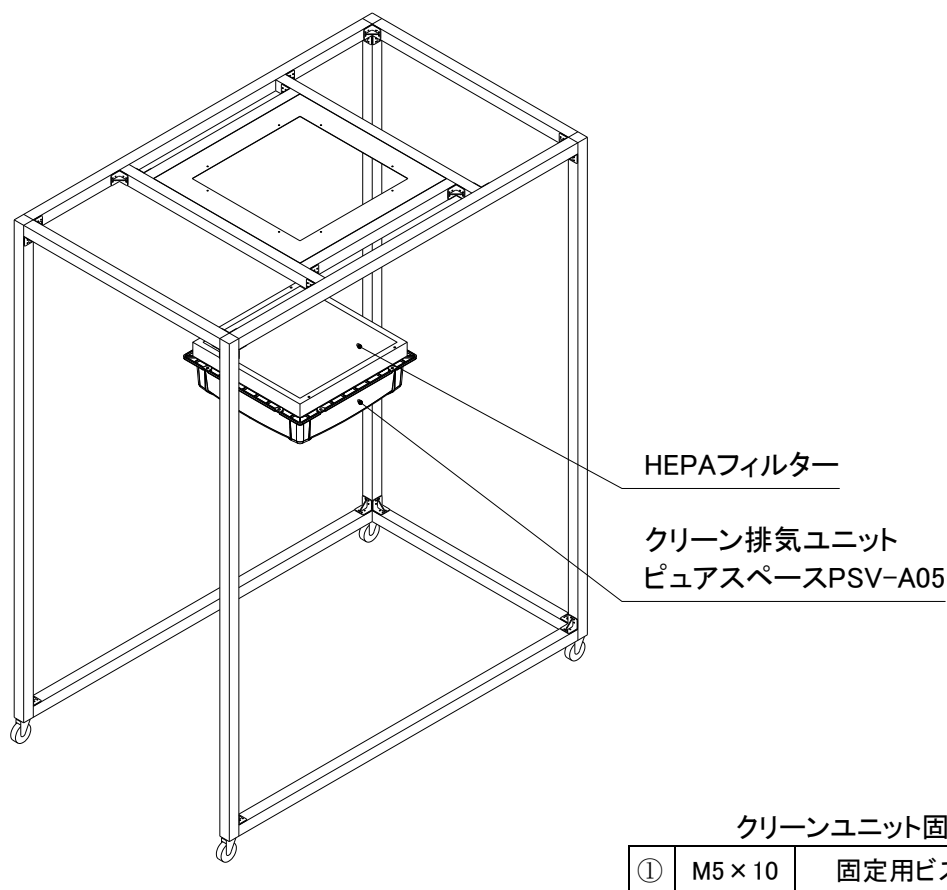


図-2

5. 図-3のようにカーテン吊り具を天面枠周囲に引掛けてください。
6. 側面カバーを周囲に巻き、側面カバーのハトメをカーテン吊り金具に引掛けてください。
正面側はカーテンが約350mm程重なり、出入り口となります。
7. 側面カーテンを引掛けてから、天面カバーが側面カーテンの上に被るようにして被せてください。
8. **カーテンに添加してある貼り付き防止の粉末を拭き取ってください。**
9. 電源プラグをコンセントに差し、クリーンユニットに別冊として添付の取扱説明書を参照し、クリーンユニットを運転してください。
ユニット上部のHEPA フィルターからエアーが出ている事をご確認ください。


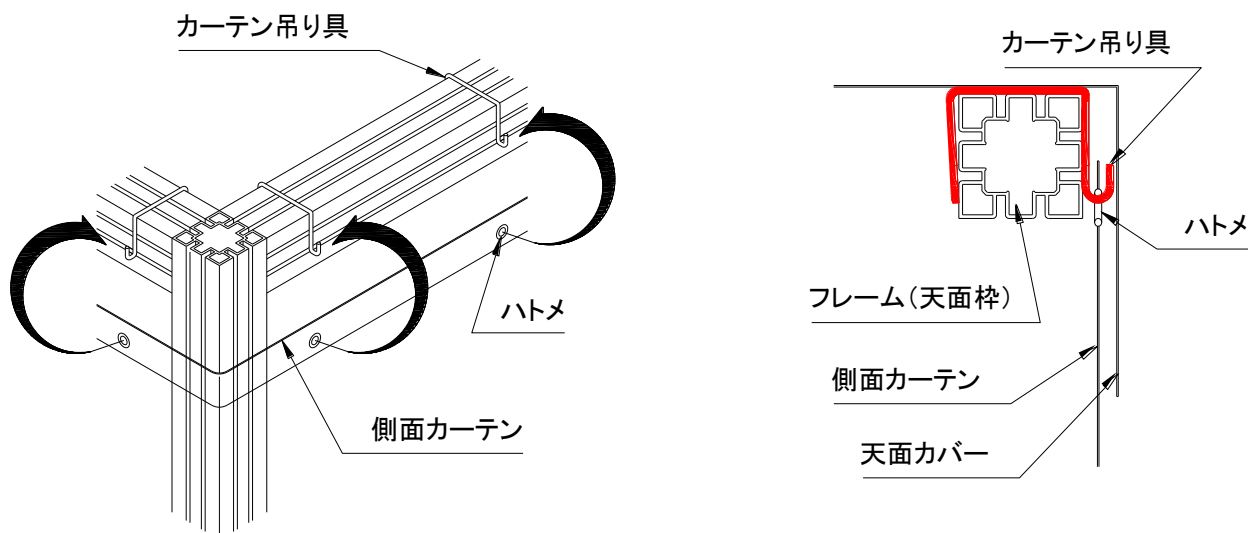


図-3

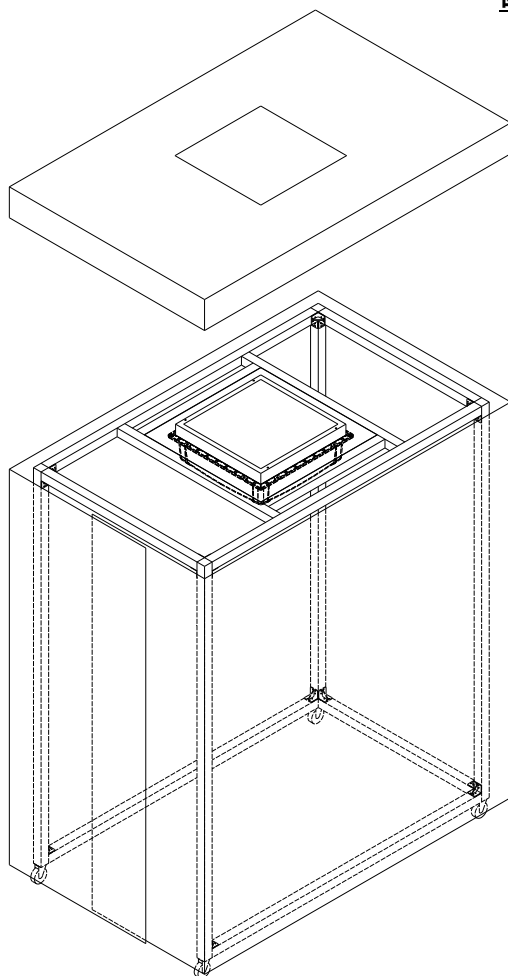

<HEPA フィルター、プレフィルターについて>

クリーンユニットに別冊として添付の取扱説明書をご参照頂き、清掃・交換を実施してください。

<お手入れについて>

清掃は、お湯又は水を硬く絞った柔らかい布で拭いてください。

取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

⚠ 警 告	
	・お手入れの際は、安全のため、必ずクリーンユニットのスイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
	・清掃する場合は、外装や架台部分に直接水をかけたりしますと感電等の事故原因になりますので、絶対にしないで下さい。
⚠ 注 意	
	・クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。

<仕様>

枠サイズ (mm)		W900×D1500×H1900
本体サイズ (mm) ユニット含む		W900×D1500×H1954
材質	本体フレーム	アルミ型材/アルマイト処理
	天面カバー	帯電防止透明ビニール t0.3
	側面カーテン	

製品保証について

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定(1)に基づく正常な仕様状態での故障の節は右記保証規定により修理いたします。

品名	発塵作業用ブース
型式	FKD-EG915A
機番	
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様様	様
ご住所	TEL:
取り扱い店名	担当者印
住所	TEL:

アズワン株式会社

〈保証規定〉

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・ 誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・ 本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - ・ 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・ 接続している他の機器が原因による故障。
 - ・ 車両・船舶等での使用による故障。
 - ・ 消耗部品、付属部品の交換。
 - ・ 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ
専用URL

<http://help.as-1.co.jp/q>

■修理・校正についてのお問い合わせは

テクニカルセンター

フリーダイヤル  0120-788-535

FAX 0120-788-763

問い合わせ
専用E-mail

repair@so.as-1.co.jp

受付時間: 午前 9 時～12 時、午後 1 時～5 時 30 分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

2014 年 3 月 初版作成