




※図中の寸法は概寸法である

名称 ピオラモPCR 0.2mlフラット	年月日	殿			
図名 外形参考図	No.	アズワン株式会社			
縮尺		図面番号	承認	検図	製図
訂正	・	・			設計
	・	・			
	・	・			
	・	・			

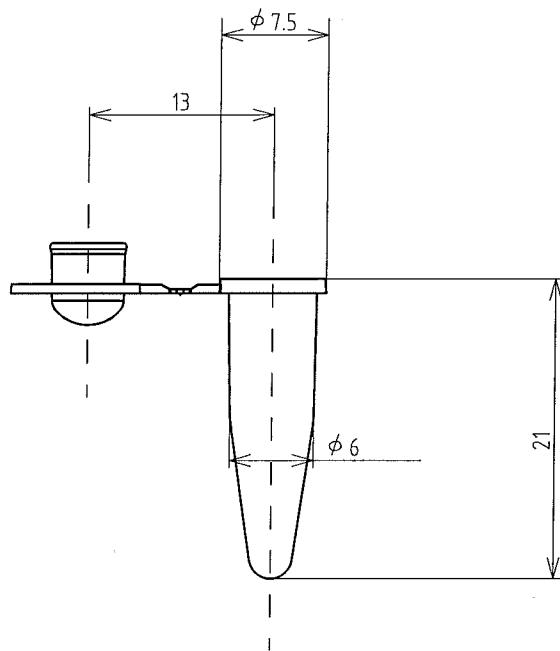



*図中の寸法は概寸法である

名称 ビオラモPCR 0.2mlドーム	年月日	殿			
図名 外形参考図	No.	アズワン株式会社			
縮尺		図面番号	承認	検査	製図
訂正	・	・			設計
	・	・			
	・	・			
	・	・			

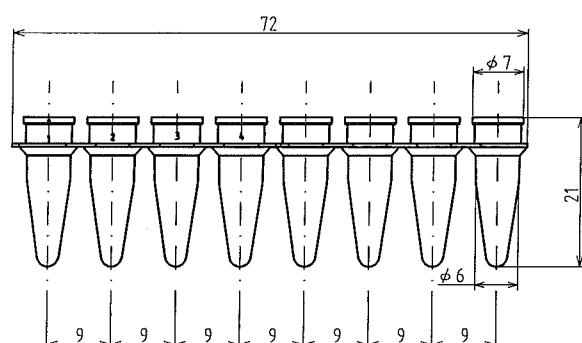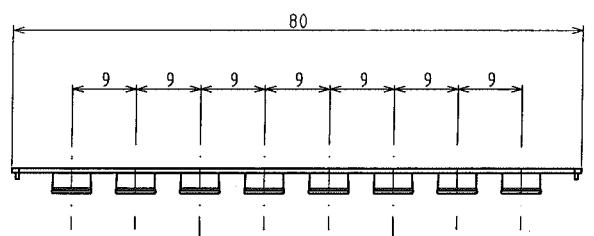

※図中の寸法は概寸法である

名称	PCRチューブ8連フラット	年月日	殿			
図名	外形参考図	No.	マスワニ株式会社			
縮尺		図面番号	承認	検査	製図	設計
訂正	.	.				
	.	.				
	.	.				
	.	.				

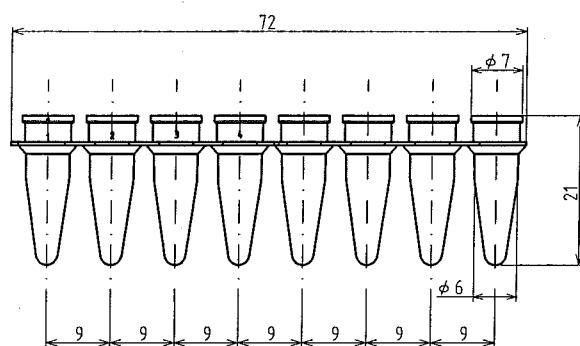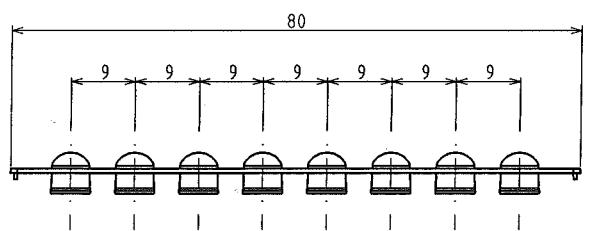

*図中の寸法は概寸法である

名称 PCRチューブ8連ドーム	年月日	殿			
図名 外形参考図	No.	アズワン株式会社			
縮尺		図面番号	承認	検図	製図
訂正	・				設計
	・				
	・				
	・				