

取扱説明書

3-2048-02

ラボドラフト 卓上タイプ Z9P-TSXT

お買い上げ有り難うございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。

本製品をより安全に、また、良好な状態でご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

また、製品を末永くご使用いただくために、この「取扱説明書」は大切に保管してください。

本品を譲渡・貸与される時には、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱い説明書を、製品本体と共に必ずお渡しください。

 **アズワン株式会社**

安全上のご注意

この取扱説明書では製品を安全に、正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って、安全にご使用いただくようお願い申し上げます。

各警告表示の定義

	危険	取扱いを誤ると、死亡または重症を負う可能性があります。
	警告	取扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
	注意	取扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
	お願い	安全を確保するために注意が必要な事項。

安全確保の図記

	特定しない一般的な注意、警告、禁止事項		分解及び改造により感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止
	機器の特定の場所に触れると傷害が起こる可能性がある場合の禁止		感電の危険性の注意
	高温による傷害が起こる可能性がある場合の注意		破裂、爆発の危険性の注意
	指を挟みこむ危険がある場合の注意		ファン等に巻き込まれる危険性の注意
	特定しない一般的な使用者の行為		アース線の接続の指示

<設置上の安全に関する注意>

製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、適切な場所をお選びください。


⚠ 警告	
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 本製品は防爆構造ではありません。近くに引火性、爆発性の固体・液体・気体のないところに設置してください。 ◆ 極端な高温、低温、高湿、乾燥した場所ではご使用にならないでください。 ◆ 屋内に設置してください。この製品は、屋外で使用することはできません。
⚠ 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 水平で安定したところに設置してください。 ◆ 直射日光のあたらないところ設置し、ご使用ください。 ◆ 冷暖房、換気設備の吹き出し口近く、及び通行人が多く、頻繁に乱気流が起こりうる場所への設置は極力避けてください。ガス漏れの原因となります。 ◆ 電源コードは、足を引っ掛けないところに取りまわしてください。

<使用上の安全に関する注意>

⚠ 警告	
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 排気ファンが運転されていない状態(排気されていない状態)で使用しないでください。 ◆ ドラフト内の温度が 60°C を超えるような作業や実験は行わないでください。 ◆ ドラフト内で作業や実験を行う時は、十分な前面風速を確保するために、開口部ができるだけ小さくなるような位置に、扉を止めてください。十分な前面風速がない場合は危険です。
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 使用前は必ず、照明器具の周波数切替スイッチが、使用される地域の周波数に合っている事を確認してください。合っていない場合は、使用される地域の周波数に合わせてください。また、周波数の違う地域へ移転される場合も、合わせ直してください。周波数が合っていないと安定器が焼損して、火災などの原因となる場合があります。 ◆ 本製品はファンモーターの保護として、サーマルリレーを組込んでいます。使用前は必ずサーマルリレーの設定値が、使用される地域に合っている事を確認してください。合っていない場合は、使用される地域の周波数の設定値に合わせてください。また、周波数の違う地域に移転する場合も合わせなおしてください。正しく設定しないと、保護機能が正常に働かなくなり、ファンモーターが焼損して、火災などの原因となる場合があります。
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 改造及び分解はしないでください。改造及び分解したものを使用して事故がおきた場合、当方は一切の責任を負いかねます。
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 爆発事故・火災事故を避けるために、ドラフト内や架台内には爆発性物質・引火性物質を入れないでください。また、それらを含んだり、付着した容器なども入れないでください。
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 濡れた手でのスイッチ操作や、コンセントの抜き差しは行わないでください。感電の恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ アースは必ず接続してください。アースを接続されないと感電事故の原因となります。

!注意	
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 排気ファンは運転させドラフトとしての機能が働いている状態でご使用下さい。 ◆ 本製品はPVC製です。有機溶剤全般に侵されますので、有機溶剤は一切使用しないでください。 ◆ 扇の質量が変わるような加工や、物をつけてないでください。扇とウエイトのバランスが崩れて、扇が勝手に上下する恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ドラフトの天面に物を置いたりしないでください。 ◆ 扇は、ゆっくり開閉して衝撃を与えないでください。破損する恐れがあります。又、手などを挟まないよう注意してください。 ◆ 定期的に<保守・点検>の事項を参照して、点検を行ってください。
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 扇レール部や、天面のローラー部には手を触れないでください。指を挟んでケガをする恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 長時間使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。又、電源プラグを抜く時は、コードを持たずに先端のプラグを持って抜いてください。

<各部の名称>

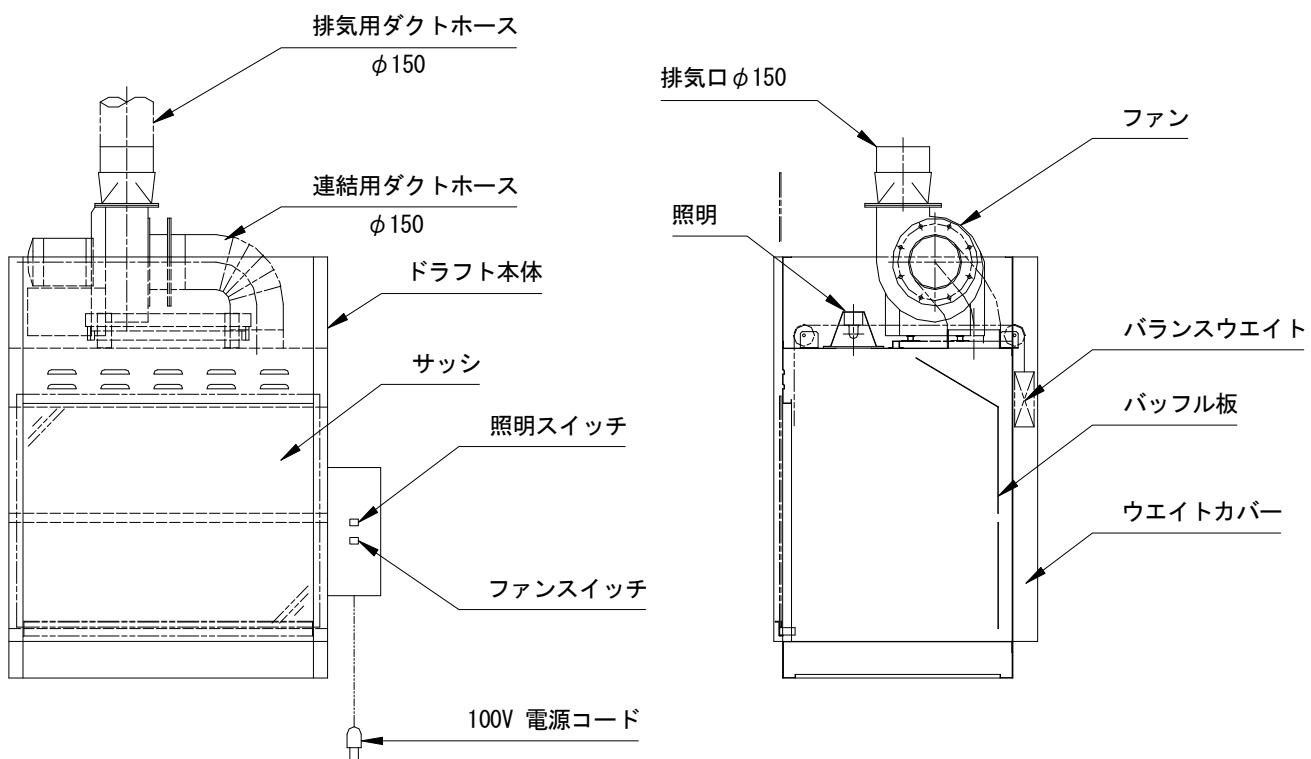

<設置方法>

1. 設置上の安全に関する注意の条件を満たす所に本製品を置いてください。
2. ドラフト天面に設置の蛍光灯器具の周波数を地域に合わせてセットしてください。
周波数の切替は、蛍光灯器具に 50-60Hz の周波数切替スイッチがついています。
(工場出荷時は 50 Hz に合わせています。)

3. スイッチボックスの蓋を開き、内部に設置のサーマルリレー(図 1)のダイヤル(⇒部)を図 2 を参照して、プラスドライバーでまわして合わせてください。

図 2


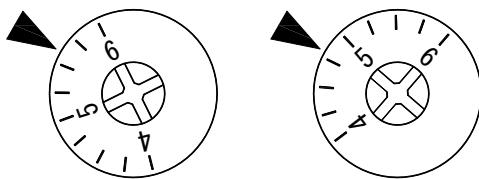


図 1

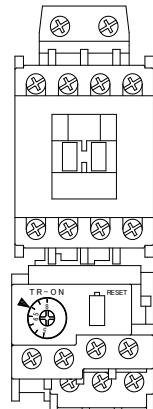

サーマルリレー

4. ドラフト天面(図 3)にファン固定用ネジが 4箇所ありますので、別梱包の耐酸ファンを図 4 と同じ向きになるようにし、ファンの台についている穴と固定用ネジを合わせて、付属のナットを使用して天面にファンを固定してください。

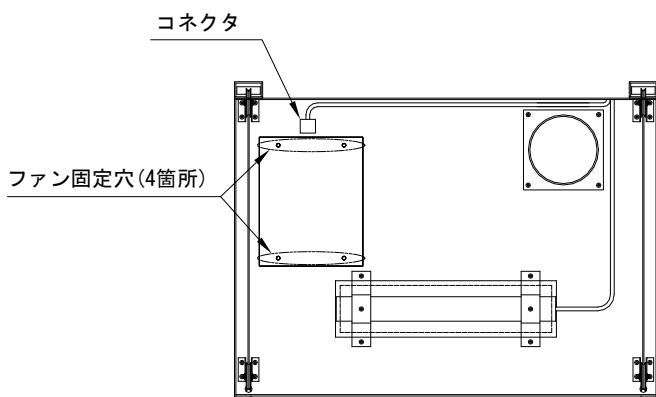


図 3

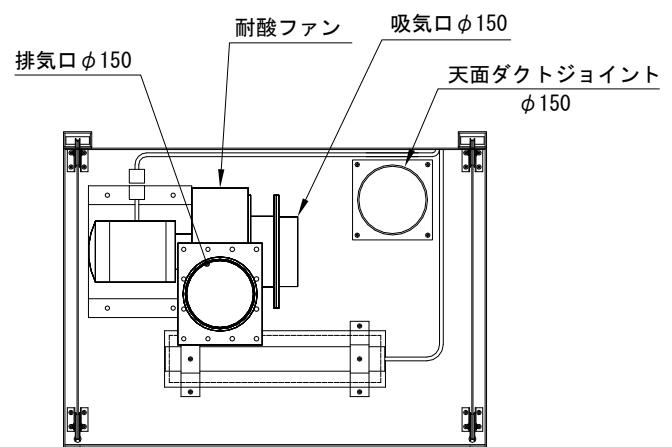


図 4

5. 付属のダクトホース φ150(短)を、天面ダクトジョイントと吸気口に接続し、ホースバンドでダクトホースを固定します。
6. 付属のダクトホース φ150(長)の片側端部を排気口に接続し、ホースバンドで固定します。そして、逆の端部を室外に導いてください。
7. ドラフト天面のコネクタとファンから出ているコネクタを連結してください。

<ドラフト使用方法>

1. 排気ファンを作動させて、風速を測定してからご使用ください。
扉を半開にした状態で 0.5m/s が基準です。
 2. 作業中は扉を開口の 1/2 (=半開) の高さで使用してください
 3. 作業終了後もしばらくの間ファンを作動させてドラフト・スクラバー及びダクト内の残留ガスを排気してください。
 4. ドラフト使用後はフード内を綺麗に清掃してください。
- 使用した薬品類は、フード内から出して薬品庫に保管してください。

<保守・点検方法>

- ◆ 漏電ブレーカのテストを月 1 回以上行ってください。電源が接続されているとき、漏電ブレーカが ON の状態で漏電ブレーカのテストボタンを押してください。漏電ブレーカが OFF になれば正常です。
- ◆ 実験中に薬品が飛び散った場合には、速やかに拭き取ってください。
- ◆ 定期的にバランスウェイトを取付けているワイヤーの点検をドラフト上部より行なってください。ワイヤーの被覆が破れ、ワイヤーに錆が見られる場合は修理・交換を依頼してください。
▲そのままご使用になられますとワイヤー切斷の可能性があり、非常に危険です
- ◆ 蛍光灯が点灯しなくなった場合は、ドラフト上部より蛍光灯またはグローランプを交換してください。
- ◆ 風速測定は定期的に行い、記録を残してください。管理責任者をおかれることを推奨します。

<お手入れについて>

- ◆ お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- ◆ 清掃は、お湯又は水を硬く絞った柔らかい布で拭いてください。
- ◆ 取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

⚠ 警告	
	<ul style="list-style-type: none"> ・お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 ・清掃する場合は、外装や内部に直接水をかけたりしますと漏電等の事故原因になりますので、絶対にしないでください。
⚠ 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> ・クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。

<仕様>

	Z9P-TSXT
外寸法 W×D×H(mm)	900×685×1150(排気ファン含まず)
開口間口寸法 W×H(mm)	820×620
材質	ドラフト本体: 塩化ビニール(PVC) アイボリー 扉: 透明塩化ビニール(PVC)
扉昇降方法	バランスウェイト式
照明	蛍光灯 15W 1灯 50/60Hz 切替式
電源コード	接地型 2P プラグ付コード 2.5m、0A アダプター付
ヒューズ	ガラス管ヒューズ φ6×30 1A(照明)
電源	AC100V 15A 50/60Hz
耐酸ファン(No.150)	1φ 100V 0.2Kw シロッコファン 最大風量: 8/10[m ³ /min] 最大静圧: 100/150[Pa]
推薦排気風量	サッシ半開、面速 0.5m/s の時 8.0 m ³ /min

<付属品>

	付属品名	数
付属品	耐酸ファン(No.150)	1台
	ダクトホース(茶色) φ150×2.5m 排気用	1本
	ダクトホース(茶色) φ150×0.55m 連結用	1本
	ファン固定用ナット・ワッシャー・スプリングワッシャ	4set

初版 2017年02月作成

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

フリーダイヤル  0120-700-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ
専用URL<http://help.as-1.co.jp/q>

■修理・校正についてのお問い合わせは

テクニカルセンター

フリーダイヤル  0120-788-535

FAX 0120-788-763

問い合わせ
専用E-mailrepair@so.as-1.co.jp受付時間: 午前9時~12時、午後1時~5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。