


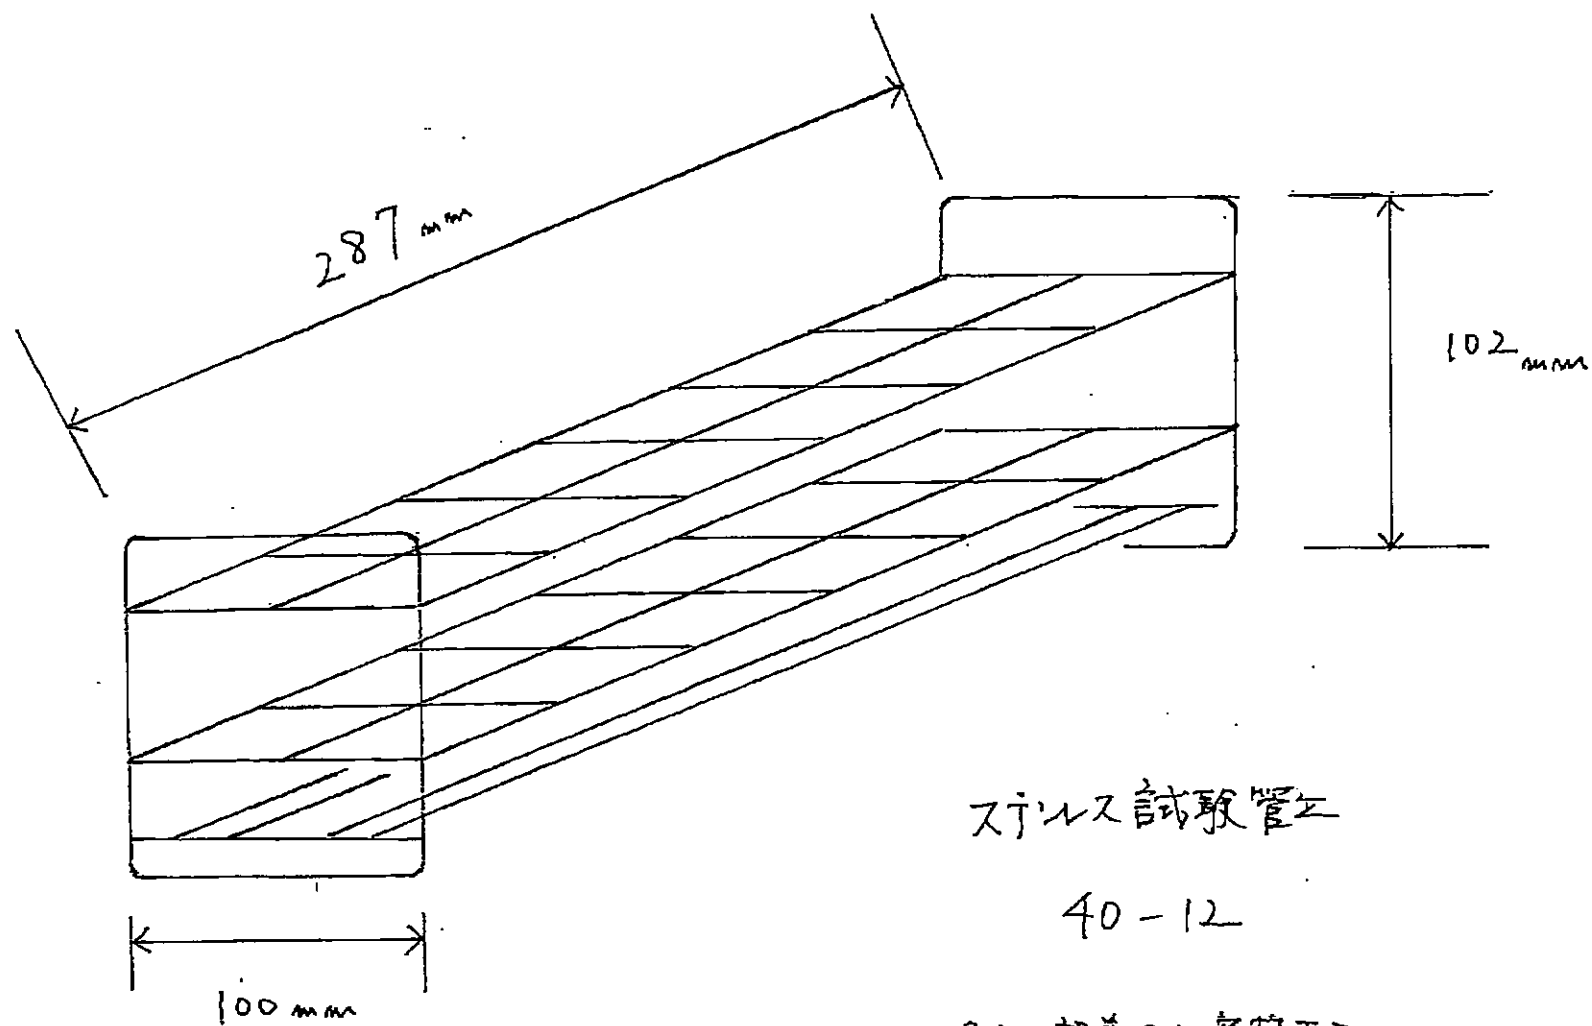

スリルス試験管

40-12

为少の誤差は、容収下ミ